


化州市人民医院医疗设备技术参数要求表

申请科室	耳鼻咽喉头颈外科	设备名称	耳内镜 0 度
参数要求	<p>一、拟购置设备的实质性条款 (“★”号参数):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ★工作长度: 110mm±3% 2. ★最大插入部外径 (镜体外径): ≤2.7mm 3. ★视场角: 75° ±15% 4. ★有效景深范围: 3~100mm <p>二、拟购置设备的重要条款 (“▲”号参数)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ▲视向角: 0° ±3° 2. ▲光纤接口可与国产品牌及进口史托斯、WOLF 等导光束连接。 <p>三、拟购置设备的其他参数 (含可维护性)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 镜主体: 采用轻质医用不锈钢材质 2. 光学结构: 新型光学系统设计, 采用蓝宝石玻璃, 柱状晶体排列技术, 进口光纤材料有效提高光强度, 高清分辨率。 3. 采用过氧化氢低温等离子灭菌方式: 灭菌室内温度 50-60℃, 过氧化氢加入 3 次 (设备默认每次加入量 3.0-3.5ml), 过氧化氢浓度 55-62%, 灭菌时间 70min。 		
配置清单要求	产品名称: 耳内镜 规格: 2.7*110mm 0°		
质保年限要求 (年) (从主机及配套设备质保期方面描述)	1 年		
其他要求			
申请科室质控小组意见	<p style="font-size: 2em; text-align: center;">同意申请</p> <p style="text-align: right;">签名: 日期: 2025-12-24</p>		
说明	<p>打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。</p> <p>打“▲”号条款为重要技术参数, 若有部分“▲”条款未响应或不满足, 不作为无效投标条款。</p>		

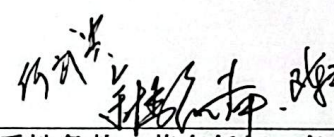
化州市人民医院医疗设备技术参数要求表

申请科室	耳鼻咽喉头颈外科	设备名称	耳内镜 30 度
参数要求	<p>一、拟购置设备的实质性条款 (“★”号参数):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ★工作长度: 110mm±3% 2. ★最大插入部外径 (镜体外径): ≤2.7mm 3. ★视场角: 75° ±15% 4. ★有效景深范围: 3~100mm <p>二、拟购置设备的重要条款 (“▲”号参数)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ▲视向角: 30° ±3° 2. ▲光纤接口可与国产品牌及进口史托斯、WOLF 等导光束连接。 <p>三、拟购置设备的其他参数 (含可维护性)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 镜主体: 采用轻质医用不锈钢材质 2. 光学结构: 新型光学系统设计, 采用蓝宝石玻璃, 柱状晶体排列技术, 进口光纤材料有效提高光强度, 高清分辨率。 3. 采用过氧化氢低温等离子灭菌方式: 灭菌室内温度 50-60℃, 过氧化氢加入 3 次 (设备默认每次加入量 3.0-3.5ml), 过氧化氢浓度 55-62%, 灭菌时间 70min。 		
配置清单要求	产品名称: 耳内镜 规格: 2.7*110mm 30° 数量: 10 支		
质保年限要求 (年) (从主机及配套设备质保期方面描述)	1 年		
其他要求			
申请科室质控小组意见	<p style="font-size: 2em; font-family: cursive;">同意申请</p> <p>签名:  日期: 2025 7 2 24</p>		
说明	<p>打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。</p> <p>打“▲”号条款为重要技术参数, 若有部分“▲”条款未响应或不满足, 不作为无效投标条款。</p>		

化州市人民医院医疗设备技术参数要求表

申请科室	耳鼻咽喉头颈外科	设备名称	鼻内镜 70 度
参数要求	<p>一、拟购置设备的实质性条款 (“★” 号参数):</p> <p>1. ★工作长度: 175mm±3%</p> <p>2. ★最大插入部外径 (镜体外径): ≤4mm</p> <p>3. ★视场角: 105° ±15%</p> <p>4. ★有效景深范围: 3~100mm</p> <p>二、拟购置设备的重要条款 (“▲” 号参数)</p> <p>1. ▲视向角: 70° ±3°</p> <p>2. ▲光纤接口可与国产品牌及进口史托斯、WOLF 等导光束连接。</p> <p>三、拟购置设备的其他参数 (含可维护性)</p> <p>1. 镜主体: 采用轻质医用不锈钢材质</p> <p>2. 光学结构: 新型光学系统设计, 采用蓝宝石玻璃, 柱状晶体排列技术, 进口光纤材料有效提高光强度, 高清分辨率。</p> <p>3. 采用过氧化氢低温等离子灭菌方式: 灭菌室内温度 50-60℃, 过氧化氢加入 3 次 (设备默认每次加入量 3.0-3.5ml), 过氧化氢浓度 55-62%, 灭菌时间 70min。</p>		
配置清单要求	产品名称: 鼻内镜 规格: 4*175mm 0°		
质保年限要求 (年) (从主机及配套设备 质保期方面描述)	1 年		
其他要求			
申请科室质控小组意见	同意申请 签名: 李德志 日期: 2025-12-24		
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数, 若有部分“▲”条款未响应或不满足, 不作为无效投标条款。		

化州市人民医院医疗设备技术参数要求表

申请科室	耳鼻咽喉头颈外科	设备名称	鼻内镜 0 度
参数要求	<p>一、拟购置设备的实质性条款 (“★” 号参数):</p> <p>1. ★工作长度: 175mm±3%</p> <p>2. ★最大插入部外径 (镜体外径): ≤4mm</p> <p>3. ★视场角: 105° ±15%</p> <p>4. ★有效景深范围: 3~100mm</p> <p>二、拟购置设备的重要条款 (“▲” 号参数)</p> <p>1. ▲视向角: 0° ±3°</p> <p>2. ▲光纤接口可与国产品牌及进口史托斯、WOLF 等导光束连接。</p> <p>三、拟购置设备的其他参数 (含可维护性)</p> <p>1. 镜主体: 采用轻质医用不锈钢材质</p> <p>2. 光学结构: 新型光学系统设计, 采用蓝宝石玻璃, 柱状晶体排列技术, 进口光纤材料有效提高光强度, 高清分辨率。</p> <p>3. 采用过氧化氢低温等离子灭菌方式: 灭菌室内温度 50-60℃, 过氧化氢加入 3 次 (设备默认每次加入量 3.0-3.5ml), 过氧化氢浓度 55-62%, 灭菌时间 70min。</p>		
配置清单要求	产品名称: 鼻内镜 规格: 4*175mm 0°		
质保年限要求 (年) (从主机及配套设备质保期方面描述)	1 年		
其他要求			
申请科室质控小组意见	<p style="font-size: 2em; text-align: center;">同意申请</p> <p style="text-align: center;"> 签名:  日期: 2025-12-24 </p>		
说明	<p>打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。</p> <p>打“▲”号条款为重要技术参数, 若有部分“▲”条款未响应或不满足, 不作为无效投标条款。</p>		