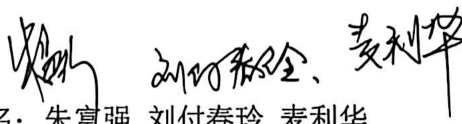


化州市人民医院医疗设备技术参数要求表

申请科室	病理科	医疗设备名称	冰冻切片机
参数要求	一、拟购置设备的实质性条款（“★”号参数）： 二、拟购置设备的重要条款（“▲”号参数） ▲双压缩机实现腔体与样本头单独制冷，轻松处理脂肪与织密组织。 ▲冷冻箱自动除霜功能：每 24 小时一次，有时间控制（持续时间 12 分钟）。 ▲速冻架冷冻位点：15+2 个，速冷架制冷温度最低达：-42℃。 ▲切片厚度调节：箱体外部，保护操作者安全，切片厚度范围：1-100 um，1.0um —5.0 um 以 0.5um 递进， 5.0um —20.0 um 以 1.0um 递进，20.0um —60.0um 以 5.0um 递进，60.0um —100.0um 以 10.0um 递进。 ▲修块厚度：临床型设定值：10——40um，10um 、20um 、30um 、40um ；科研型设定值：1——600um ，连续设定。 ▲电动粗进速度：2 档；快：0.9mm/s，慢：0.3mm/s。 ▲样品回缩：20um 或者关闭。 ▲抗菌银离子表面涂层有效组织感染性物质在仪器外部的繁殖。 ▲经过有效性认证的（UV）紫外线箱体内部消毒有效灭活新冠病毒等有害微生物，避免毒性消毒水使用，并可在低温环境下完成消毒无需恢复至室温再运行；30 或 180 分钟，用户可选。 ▲刀架冷空气循环技术，智能刀架制冷不易结霜，易于长时间切片避免产生冰晶。 ▲（选配）负压抽吸系统，切片废屑负压清除系统，即可轻松去除切片废屑。 三、拟购置设备的其他参数（含可维护性） 按键式操作机身，便于戴手套操作。 冷冻箱制冷温度：0℃～-35℃。		

	带冷冻箱手动除霜功能，手动热气除霜。 Peltier 位点：2 个。 样品头制冷可达-53℃ 。 样品定位：8° 定位及 360° 旋转，自动中心定位和精确 0 位指示确保样本定位顺利进行。 HEPA 空气净化系统确保安全的实验室环境。 设备顶部预留充足的储物空间，方便操作；底部预留腿部空间，站姿与坐姿皆可提供舒适的切片体验。
每台医疗设备配置清单要求	1、主机整机（双压缩机）1 台 2、UV 消毒系统 1 套 3、刀架数量 1 个 4、刀夹数量 1 个 5、样品托数量 5 个 6、工具包数量 1 套 7、防卷玻璃数量 1 个 8、设备资料 1 套
质保年限要求（年） （从主机及配套设备质保期方面描述）	5 年
其他要求	
申请科室质控小组意见	同意。  签名：朱富强 刘付春玲 麦利华 日期：2026-03-11
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，不作为无效投标条款。